

	D Reagenz enthält Ethanol. Leichtentzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.
F Leichtentzündlich Highly flammable	US Reagent contains ethanol. Highly flammable. Keep out of the reach of children. Keep container tightly closed. Keep away from sources of ignition – No smoking.
Facilement inflammable	F Le réactif contient la substance éthanol. Facilement inflammable. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ätzcelles – Ne pas fumer.
Licht ontvlambaar	NL Reagents bevat ethanol. Licht ontvlambaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken.
Facilmente inflamável	I Il reagente contiene etanol. Facilmente inflamável. Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare.
Pachamere inflamable	E El reactivo contiene etanol. Facilmente inflamable. Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantenga el recipiente bien cerrado. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar.
Facilmente inflamável	P O reagente contém etanol. Facilmente inflamável. Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Manter afastado de qualquer

chama ou fonte de ignição – Não fumar.

S Reagens innehåller etanol. Mycket brandfarligt. Förvaras oåtkomlig för barn. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden.

FI Reagenssi sisältää etanolia. Helposti sytytysvää. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä tiivisesti suljettuna. Eristettävä sytytyslähteistä – Tupakointi kielletty.

DK Reagens indeholder etanol. Meget brandfarlig. Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen skal holdes tæt lukket. Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt.


GR Η αντρόσαπτο περιέχει ειδικάνως. Πολύ εύφλεκτο. Μοκρής από παιδιά. Το δοχείο να διατηρείται εργμήτη κλεισμένο. Μοκρής από πηγές ανάφλεξης – Απογραφέεται το κόπτιμα.

SI Reagent vsebuje etanol. Lahko vnetljivo. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kadite.

H A reagens etanol tartalmaz. Tüzeszéllyes. Gyermek kezébe nem kerülhet. Az edényzet légmentesen lezárvatartandó. Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás.

PL Odczynnik zawiera etanol. Produkt wysoce łatwopalny. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczególnie zamknięty. Nie przechowywać w pobliżu źródła zapłonu – nie pali tytoniu.

CZ Činidlo obsahuje etanol. Vysoko hořlavý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte mimo dosah zdrolů zapálení – zákaz kouření.

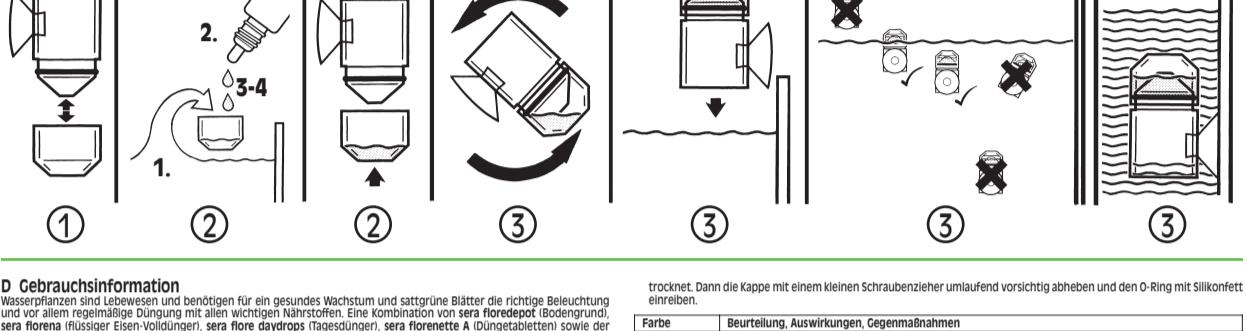

D Gebrauchsinformation

Wasserpflanzen sind Lebewesen und benötigen für ein gesundes Wachstum und sattgrüne Blätter die richtige Beleuchtung und vor allem regelmäßige Düngung mit allen wichtigen Nährstoffen. Eine Kombination von sera floredopot (Bodengrund), sera florena (flüssiger Eisen-Vollkörper), sera flora daydrops (Tageslungen), sera florenette A (Düngetabletten) sowie der sera CO₂-Düngungseinheit sorgt für prächtige Pflanzentwuchs und stabile Wasserverhältnisse in Ihrem Aquarium.

Gebrauchsrichtlinien:

1. Pyramidenförmige Kappe abziehen und hin knapp unter den Rand mit Aquariumwasser füllen (ca. 1,5 ml).
2. 3 – 4 Tropfen CO₂-Indikatorflüssigkeit zugeben und Unterteil wieder aufsetzen.
3. Testgerät umdrücken und mit dem Saughalter senkrecht im Aquarium befestigen (siehe Abb. 3). Bitte unbedingt in dieser Reihenfolge vorgehen, nicht umgedreht! Dies kann zu Fehlmessungen und ggfs. zu Beschädigungen führen!
- Wichtig! Sie darf auf, dass der untere Hohlräum nur teilweise mit Wasser gefüllt ist.
4. Farbvergleichsanzeige auf außen an die Aquarienscheibe in die Nähe des Testgerätes kleben, so dass ein direkter Farbvergleich möglich ist.
5. Nach einiger Zeit verblasst die Farben im sera CO₂-Dauertest. In dem Fall muss das Testgerät erneut mit Aquariumwasser und Indikatorflüssigkeit gefüllt werden, wie unter Punkt 1. – 3. beschrieben. Testgerät saubern.
6. Wenn die Kappe des Testgerätes sich nicht oder nur schwer abnehmen lässt, ist die Silikonfettung des O-Rings einge-

trocken. Dann die Kappe mit einem kleinen Schraubenzieher umlaufend vorsichtig abheben und den O-Ring mit Silikonfett einreiben.

Farbe	Beurteilung, Auswirkungen, Gegenmaßnahmen
blau	zu wenig CO ₂ , Pflanzen kümbern, CO ₂ -Zufuhr erhöhen (Gebrauchsinformation der Düngeanlage beachten)
dunkelgrün	richtiger CO ₂ -Gehalt
hellgrün	zu viel CO ₂ . Fische stehen schwer atmend an der Wasseroberfläche oder schwimmen ruckartig durchs Wasser. CO ₂ -Zufuhr vermindern, gut durchlüften und CO ₂ austreiben

Achtung: Auf Änderungen des CO₂-Gehaltes im Aquariumwasser reagiert der sera CO₂-Dauertest mit 30 – 60 min. Verzögerung. Wenn sich der Wasserstand im Testgerät ungewöhnlich schnell ändert, schließe die Kappe nicht oder der O-Ring ist spröde geworden und muss ausgetauscht werden. Bitte prüfen und korrigieren. Nach Gebrauch Reagenzflasche sofort wieder gut verschließen. Bei Raumtemperatur (15 – 25 °C) und vor Licht geschützt aufzubewahren. sera Qualitätsprodukte und Beratung erhalten Sie im Fachhandel.

US Information for use

Aquatic plants are living beings that require correct lighting and, above all, regular fertilization with all important nutrients for their healthy growth. A combination of sera floredopot (gravel substrate), sera florena (liquid mineral fertilizer with iron), sera flora daydrops (daily fertilizer), sera florenette A (fertilizer tablets) and the sera CO₂ fertilization system ensures lush plant growth and stable water conditions in your aquarium.

Directions for use: Shake indicator solution bottle well before using!

1. Remove the pyramid-shaped cap and fill it with the aquarium water (approx. 1.5 ml), to just below the edge.
2. Add 3 – 4 drops of indicator solution, and put the pyramid-shaped cap back on.
3. Insert the testing device and mount it vertically to the aquarium glass (see fig. 3) using the provided suction cup. Follow this procedure carefully; otherwise it will lead to inaccurate results and eventually cause damage to the testing device!

Please note: Ensure the hollow space under the device is only partly filled with water.

4. Attach the color decal to the outside glass of the aquarium. Close to the testing device, to compare the ongoing test colors.

5. After a prolonged period, the color in the testing device will fade. When this happens, refill the indicator solution and aquarium water, as described above 1 to 3. Clean the testing device.

6. If you have difficulty removing the cap of the testing device, it means the silicon grease on the O-ring has dried up. In this case, carefully remove the cap with a small screwdriver and grease the O-ring with silicone.

case, carefully remove the cap with a small screwdriver and grease the O-ring with silicone.

Color	Evaluation, effects, measures and corrective measures
blue	insufficient CO ₂ . Plants will not grow properly. Increase CO ₂ dosage. Follow the directions for use on the sera CO ₂ fertilization system
dark green	correct CO ₂ level
light green	too much CO ₂ . Fishes stand heavily near the water surface or swim abnormally. Lower the CO ₂ dosage. Aerate the water to expel CO ₂ from the water

Important: The sera CO₂ long-term indicator reacts with changes of CO₂ in aquarium water. Reaction time may have a delay of 30 to 60 minutes. If the water level in the testing device changes rapidly, it means the cap is not tightly fitted or the O-ring has become brittle and must be replaced. Please check and correct. Close reagent bottle immediately after use. Store at room temperature (15 – 25 °C / 59 – 77°F) and away from light. For testing ornamental fish aquaria and pond water only.

F Information mode d'emploi

Les plantes aquatiques sont des êtres vivants et ont besoin, pour une croissance saine et des feuilles d'un vert intense, d'un éclairage correct et régulier et d'une fertilisation régulière avec toutes les substances nutritives essentielles. La combinaison sera floredopot (substrat), sera florena (engrais complet liquide à base de fer), sera flora daydrops (engrais quotidien), sera florenette A (fertilisant complet en pastilles) et du système de fertilisation de CO₂, sera est la garantie d'une croissance luxuriante des plantes et de conditions stables pour l'eau de votre aquarium.

Mode d'emploi : Agitez le réactif liquide avant utilisation !

1. Retirez le capuchon pyramidal et remplissez jusque sous le bord avec l'eau de l'aquarium (1,5 ml environ).
2. Ajoutez 3 à 4 gouttes de réactif liquide CO₂ et remettez en place la partie inférieure.

3. Retournez le testeur et le fixez verticalement à l'aquarium à l'aide de la ventouse (cf. fig. 3). Il est impératif de procéder dans cet ordre et non inversement, sous peine d'obtenir des mesures erronées et, le cas échéant, des dommages !

Important : Veillez à ne remplir que partiellement l'espace vide inférieur.

4. Coller la carte de comparaison des couleurs sur la vitre de l'aquarium, à l'extérieur et à proximité du testeur, pour permettre la comparaison directe et rapide.

5. Au bout d'un moment, les couleurs pâlissent dans le sera test permanent CO₂. Dans ce cas, remplissez à nouveau le testeur d'eau et de réactif liquide tel que décrit aux points 1 à 3. Nettoyez le testeur.

6. Si le capuchon du testeur ne peut être retiré ou retiré difficilement, la graisse de silicone du joint torique s'est desséchée.

Dans ce cas, enlevez avec précaution le capuchon avec un petit tournevis et enduez le joint torique de graisse silicone.

Color	Analysis, effects, measures to take
blue	too little CO ₂ , the plants are not healthy, increase the CO ₂ supply (respect the sera CO ₂ fertilization system)
dark green	correct CO ₂ level
light green	too much CO ₂ . The fish are breathing heavily near the water surface or swimming abnormally. Lower the CO ₂ dosage. Aerate the water to expel CO ₂ from the water

Attention : En cas de modification de la teneur de l'eau en CO₂, le sera test permanent CO₂ réagit avec 30 à 60 minutes de retard. Si le niveau d'eau dans le testeur se modifie de manière inhabituelle, le capuchon n'est pas étanche ou le joint torique a durci et doit être remplacé. S.v.p. vérifier et corriger. Référez bien le flacon de réactif immédiatement après utilisation. Conservé à température ambiante (15 – 25 °C) et à l'abri de la lumière. Les produits de qualité sera et conseils sont disponibles chez votre revendeur spécialisé.

Distributeur : sera France SAS, 14 Rue Denis Papin, F 68000 Colmar • Tel. : 03 89 20 80 60 • Fabricqué en Allemagne

NL Gebruikersinformatie

Waterplanten zijn levende wezens en hebben voor een gezonde groei in diepgroene bladeren de juiste verlichting en vooral regelmatige bemesting met alle belangrijke voedingstoffen nodig. Een combinatie van sera floredopot (bodembeleving), sera florena (vloeibare ijzer-vuller), sera flora daydrops (dagelijkse bemesting), sera florenette A (mesttablatten) en het sera CO₂-bemestingsysteem, zorgt voor een uitstekende groei en stabiele waterwaarden in uw aquarium.

Gebruiksaanwijzing: Indicatorvloeistof voor gebruik schudden.

1. Piramidevormige dop verwijderen en tot net onder de rand met aquariumwater vullen (ca. 1,5 ml).

2. 3 – 4 druppels CO₂-indicatorvloeistof toevoegen en onderdeel weer terugzetten.

3. Testapparaat omdraaien en met zogeheten verticaal in het aquarium bevestigen (zie fig. 3). Het is belangrijk om deze volgorde te volgen, anders kan het niet goed werken.

4. Aan de buitenkant van de buitenkant van de hoge ruimte slechts voor een deel met water gevuld is.

5. Wanneer de dop van het testapparaat niet meer goed sluit, moet u de siliconenring van de

dichtingsring ingedroogd. In dat geval moet u de dop met een kleine schroevendraaier rondom voorzichtig losmaken en de dichtingsring opnieuw met siliconen insmeren.

Color	Beoordeling, gevolgen, tegenmaatregelen
blauw	te weinig CO ₂ , planten sterven af, CO ₂ -voerder verhogen (gebruikersinformatie van het bemestings-systeem raadplegen)
vert donker	te veel CO ₂ , vissen respiëren moeilijk
vert licht	te veel CO ₂ , vissen bevinden zich zwaar ademend aan de wateroppervlak of schokkende bewegingen door het water, CO ₂ -voerder verminderen, goed ventileren en CO ₂ uitzetten

Attention : En cas de modification de la teneur de l'eau en CO₂, le sera test permanent CO₂ réagit avec 30 à 60 minutes de retard. Si le niveau d'eau dans l'intérieur du testeur varie molto rapidement, il est alors nécessaire de remplacer le joint torique.

Si le joint est cassé ou ne peut plus être serré, remplacer le joint torique par un joint torique neuf. Veuillez bien le flacon de réactif immédiatement après utilisation.

Conservez à température ambiante (15 – 25 °C) et à l'abri de la lumière. Les produits de qualité sera et conseils sont disponibles chez votre revendeur spécialisé.

Distributeur : sera Italia s.r.l., Via Camerini 110, 40018 San Pietro in Casale (BO) • Tel. 051 / 6 66 13 33

I Informazioni per l'uso

Le piante aquatiche sono esseri viventi che richiedono, oltre ad una adeguata illuminazione, una regolare concimazione che apporta in modo equilibrato tutte le sostanze nutritive. Un utilizzo combinato del sera floredopot (riserva ripristinabile di fertilizzante), sera florena (fertilizzante liquido completo a base di ferro), sera flora daydrops (fertilizzante giornaliero), della sera florenette A (fertilizzante completo in pastiglie) e del sera CO₂ impianto di concimazione garantiscono una crescita rigogliosa delle piante e condizioni dell'acqua molto stabili.

Istruzioni per l'uso: Agitez le flacone de réactif.

1. Si aggiungono 3 – 4 gocce del reagente per la CO₂ e poi si rimette il cappuccio sulla parte inferiore.

3. Si guarda lo strumento e lo si fissa con la ventosa, all'interno di un vetro dell'acquario (vedi fig. 3). E' importante procedere in questo ordine e non nel senso inverso in quanto si potrebbero altrimenti avere misurazioni errate o causare danni.

Importante: fate attenzione che la parte inferiore dello strumento sia solo parzialmente riempita d'acqua.

4. Incollate la carta colorimetrica autocolante all'esterno dell'acqua del vetro dell'acquario in prossimità dello strumento, in modo da poter agevolmente confrontare i colori.

5. Dopo qualche tempo, i colori del sera CO₂ test permanente sbiadiscono. In questo caso si deve procedere alla sostituzione dell'acqua nel cappuccio, aggiungendo nuovamente il reagente come descritto dal punto 1 al punto 3. In questa occasione è anche opportuno pulire lo strumento.

6. Se la tappa del dispositivo si toglie solo con difficoltà è segno che si è secato il grasso al silicone. In questo caso è opportuno sollevare lentamente il cappuccio, facendo leva con un cacciavite, e poi ingrassare l'O-Ring con grasso al silicone.

Colore	Giudizio, effetti, contrarie, comprobazioni
blu	trop poco CO ₂ , la crescita delle piante è stentata, aumentare l'immersione della CO ₂ (leggere le istruzioni del sera CO ₂ impianto di concimazione)
verde scuro	esatta quantità della CO ₂
verde chiaro	CO ₂ in eccesso, i pesce respirano affannosamente sotto la superficie e nuotano a scatti. E' necessario ridurre l'immersione della CO ₂ . Aerare bene per eliminare il CO ₂ in eccesso

Attenzione: Il sera CO₂ test permanente reagisce con un ritardo di 30 – 60 minuti ai cambiamenti del contenuto della CO₂ nell'acqua. Se il livello dell'acqua all'interno dello strumento varia molto velocemente è segno che il cappuccio non chiude perfettamente. Se, dopo aver controllato la perfetta posizione del cappuccio, il livello dell'acqua varia ancora è segno che l'O-Ring è secato e deve essere sostituito. Dopo l'utilizzo è importante richiedere accuratamente il flacone del reagente. Conservare a temperatura ambiente (15 – 25 °C) e al buio. I prodotti di qualità della sera e i consigli sono disponibili nei negozi specializzati.

Importato da: sera Italia s.r.l., Via Camerini 110, 40018 San Pietro in Casale (BO) • Tel. 051 / 6 66 13 33

E Información para el usuario

Las plantas acuáticas son seres vivos que necesitan de una iluminación correcta y principalmente una fertilización regular que les proporciona todos los nutrientes esenciales a un crecimiento saludable y folhas bem verdes. Una combinación de sera floredopot (substrato), sera florena (abono líquido completo con hierro y minerales), sera flora daydrops (fertilizante diario), sera florenette A (abono en forma de pastillas) bien como el sera sistema de fertilización CO₂, resultará una vegetación luxuriante y una agua con condiciones estables no seu aquário.

Instrucciones para utilizar: Agite bien la solución indicadora, antes de usar!

1. Retire a tampa em forma de pirâmide e encha quase até ao topo com a água do aquário (cerca de 1,5 ml).

2. Junte de 3 a 4 gotas de solução indicadora e recoloque a tampa.

3. Vire o conjunto de cima para baixo e fixe-o verticalmente dentro do aquário (veja fig. 3) com a ventosa. Por favor siga estas instrucciones e não de outra forma. Isso levaria a resultados errados e eventualmente à destruição do dispositivo de teste.

Importante: Note que a parte inferior está só parcialmente cheia de água.

4. Cole a escala exterior no exterior do aquário, próximo do dispositivo de teste de modo a poder comparar as cores.

5. Depois de algum tempo as cores do teste desvanecem. Neste caso a tampa deve ser recarregada com nova água e solução indicadora, como descrito nos pontos 1 a 3. Limpe o compartimento de teste.

6. Se a tampa do dispositivo no puede sacarse o sólo sale forzadamente, esto quiere decir que el lubricante de silicona del anillo obturador se ha secado. Si es así, quite la tapa con cuidado con ayuda de un pequeño destornillador y vuélvela a lubricar el anillo obturador con pasta de silicona de grasa.

Cor	Conclusões, efeitos, medidas a tomar
azul	CO ₂ insuficiente, as plantas crescerão pouco. Aumentar a dosagem de CO ₂ (siga as instruções para utilização do sera sistema de fertilização CO ₂)
verde escuro	nível de CO ₂ correcto
verde claro	CO ₂ em excesso, os peixes respiram pesadamente perto da superfície ou movem-se descoordenadamente. Reduzir a dosagem de CO ₂ , arrear bem para expulsar o CO ₂ da água

Importante: O sera CO₂ test permanente reagirá às flutuações de CO₂ dissolvido na água do aquário cerca de 30 a 60 minutos depois. Se o nível da água dentro do dispositivo de teste varia muito, a tampa deve estar mal colocada ou o vedante deve estar estragado e como tal deve ser substituído. Por favor, verifique e feche a tampa correctamente. Feche bem o reagente logo após o uso. Guardar a temperatura ambiente (15 – 25 °C) e longe da luz. Produtos de qualidade sera e informações úteis, podem ser obtidos nas lojas da especialidade.

P Instruções para utilização

As plantas aquáticas são seres vivos que necessitam de uma iluminação correcta e principalmente uma fertilização regular que lhes proporciona todos os nutrientes essenciais a um crescimento saudável e folhas bem verdes. Uma combinação de sera floredopot (substrato), sera florena (abono líquido com ferro e minerais), sera flora daydrops (fertilizante diário), sera florenette A (abono em forma de pastilhas) bem como o sera sistema de fertilização CO₂, resultará numa vegetação luxuriante e uma água com condições estáveis no seu aquário.

Instruções para utilizar: Agite bem a solução indicadora, antes de usar!

1. Tira a tampa de vidro e fecha-a bem.

2. Torna 3 – 4 gotas de indicador líquido e fecha-a.

3. Vira o conjunto de cima para baixo e fixa-o verticalmente dentro do aquário (veja fig. 3) com a ventosa. Por favor siga estas instruções e não de outra forma. Isso levaria a resultados errados e eventualmente à destruição do dispositivo de teste.

Importante: Note que a parte inferior está só parcialmente cheia de água.

Käytöohje
Akvariaosat ovat elävät eläentoja jotka vaativat oikean valaistuksen ja ennenkaikkea jatkuvat ravitsemisen kaikkila tarpeellisilla ja ravintoiltaan saavuttaakseen terveen kasvun ja syytä viihdettä lehdet. Hylteistaloille seurafloropeta (pohjaravinte), sera florena (nestemäinen rauta ja mineralivarsi), sera floro dryadrops (pöly päävähän lannoite), sera floronette A (ravintotabletti sekä sera CO₂ lannoitusjärjestelmällä) saavutat kasvuston nopean kasvun ja vakaata vesilosiuhteen akvaarioissasi. Käytöohje: Ravista indikaattoreihin hyvin ennen käyttöä!

- Poistaa pyramidiinmuotinen hattu ja täytä se hiukan alle reunaan saakka akvariaovidelällä (n. 1,5 ml).
- Sisäänpäin 3 - 4 tiipaa testiliusta ja aseta pohjaan takaisin palikoille.
- Käännä mitäkään kokoilempana ja klinittä se pyystysuoraan imukuplia (kuva 3) akvariaan. Toimi ohjeen mukaan eläin toisiaan jotta valitettavasti.
- Tärkeää: Pidä hiuli etti alimmat osat tayttaa vain osittain vedellä.
- Lihanaa värähtää akvariallaan ulospäin mittauksissaan läheille niin että värjääjä on helppo verrata.
- Siirrä ajan jälkeen testistäkseen väriltä alkavat haaleita. Silloin on mittarina vesi ja testiliusi valhdettava katso kohtat 1 - 3. Tärkeänä välttää testistäkseen puohduttavata.

DK Brugsinformation

Vandlægger din levering væsen, der før at opnå en sund vækst og sætiggrønne blade, behover rigtig belysning og regelagtlig gennemstrømning af luftgær. En kombination af sera floredopet (bundtag), sera florena (flydende jern-totalsalp), sera floro drydrops (dagslime pudring), sera floronettede (godtgivningstabletter), såvel som sera CO₂-fodningslavender, der er en prægtig plantekost på stabile forhånd i dører akvariet.

Brugsanvisning: For brug nyttes flasken grundigt.

- Den pyramidformede kappe tages af og fyldes til lige under kanten med akvarievand (ca. 1,5 ml).
- 3 - 4 dråber CO₂-indikatoriske tilslættes og underden pæssettes igen.
- Testbeholderen drenes rundt og sættes med sugekoppen lodret i akvariet (se fig. 3). Gør det venligst i denne rækkefølge, ikke omvendt. Dette kan føre til fejlmalinger og beskadigelser!

Vigtigt: Vigtigt for at få det nederste hulrum, kun er fyldt delvist med vand.

- Farekartet sættes yderst på akvarieunderen i nærheden af testbeholderen, så man kan fyde beholderen med akvarievand og indikatorveske igen under punkt 1 - 3 beskrevet. Beholderen renses først.

GR Γενικές Πληροφορίες

Τα υδρόβια από τα είναι γνωστά σφραγίδων που χρειάζονται ασθενή φωτισμό, άλλα ποιητικά, ουργή λίπωση με όλα τα θρεπτικά αυτομάτικα για την υγεία τους ανάπτυξη. Συνδυασμός του υποστρωμάτος sera floredopet, sera florena (υγρό λίπασμα μετάλλων και ασβότη), sera floro drydrops (ημέρια λίπωση), sera floronettede (τραγανές λίπωση), και το σύστημα λίπωσης διαδέσμων sera CO₂-fertilization system εφαρμόζεται έντονα ανάπτυξη φυτών και διατηρεί απόρρετη περιόδου χρήσης.

Οργάνωση: Ανακτήστε κάτια σε φιάλη με πολύτιμα ουσία και γεμίστε την με νερό σε πλήρη στάδιο.

- Απορρίψτε το πυρηνούσιος κόπων και γεμίστε το με νερό στην επιφάνεια της φιάλης 1,5ml.

2. Προσθέτε 3 - 4 φαρμάκια της CO₂-indikatoriske tilslættes og underden pæssettes igen.

3. Testbeholderen drenes rundt og sættes med sugekoppen lodret i akvariet (se fig. 3). Gør det venligst i denne rækkefølge, ikke omvendt. Dette kan føre til fejlmalinger og beskadigelser!

Vigtigt: Vigtigt for at få det nederste hulrum, kun er fyldt delvist med vand.

4. Farekartet sættes yderst på akvarieunderen i nærheden af testbeholderen, så man kan fyde beholderen med akvarievand og indikatorveske igen under punkt 1 - 3 beskrevet. Beholderen renses først.

6. Pas på at det nederste hulrum, kun er fyldt delvist med vand.

5. Etter et stykke tid blegner farven i testbeholderen. Så må man fyde beholderen med akvarievand og indikatorveske igen under punkt 1 - 3 beskrevet. Beholderen renses først.

7. Το υδρόβιο από τα είναι γνωστά σφραγίδων που χρειάζονται ασθενή φωτισμό, άλλα ποιητικά, ουργή λίπωση με όλα τα θρεπτικά αυτομάτικα για την υγεία τους ανάπτυξη. Συνδυασμός του υποστρωμάτος sera floredopet, sera florena (υγρό λίπασμα μετάλλων και ασβότη), sera floro drydrops (ημέρια λίπωση), sera floronettede (τραγανές λίπωση), και το σύστημα λίπωσης διαδέσμων sera CO₂-fertilization system εφαρμόζεται έντονα ανάπτυξη φυτών και διατηρεί απόρρετη περιόδου χρήσης.

Οργάνωση: Ανακτήστε κάτια σε φιάλη με πολύτιμα ουσία και γεμίστε την με νερό σε πλήρη στάδιο.

1. Απορρίψτε το πυρηνούσιος κόπων και γεμίστε το με νερό στην επιφάνεια της φιάλης 1,5ml.

2. Προσθέτε 3 - 4 φαρμάκια της CO₂-indikatoriske tilslættes og underden pæssettes igen.

3. Testbeholderen drenes rundt og sættes med sugekoppen lodret i akvariet (se fig. 3). Gør det venligst i denne rækkefølge, ikke omvendt. Dette kan føre til fejlmalinger og beskadigelser!

Vigtigt: Vigtigt for at få det nederste hulrum, kun er fyldt delvist med vand.

4. Farekartet sættes yderst på akvarieunderen i nærheden af testbeholderen, så man kan fyde beholderen med akvarievand og indikatorveske igen under punkt 1 - 3 beskrevet. Beholderen renses først.

5. Etter et stykke tid blegner farven i testbeholderen. Så må man fyde beholderen med akvarievand og indikatorveske igen under punkt 1 - 3 beskrevet. Beholderen renses først.

6. Το υδρόβιο από τα είναι γνωστά σφραγίδων που χρειάζονται ασθενή φωτισμό, άλλα ποιητικά, ουργή λίπωση με όλα τα θρεπτικά αυτομάτικα για την υγεία τους ανάπτυξη. Συνδυασμός του υποστρωμάτος sera floredopet, sera florena (υγρό λίπασμα μετάλλων και ασβότη), sera floro drydrops (ημέρια λίπωση), sera floronettede (τραγανές λίπωση), και το σύστημα λίπωσης διαδέσμων sera CO₂-fertilization system εφαρμόζεται έντονα ανάπτυξη φυτών και διατηρεί απόρρετη περιόδου χρήσης.

Οργάνωση: Ανακτήστε κάτια σε φιάλη με πολύτιμα ουσία και γεμίστε την με νερό σε πλήρη στάδιο.

1. Απορρίψτε το πυρηνούσιος κόπων και γεμίστε το με νερό στην επιφάνεια της φιάλης 1,5ml.

2. Προσθέτε 3 - 4 φαρμάκια της CO₂-indikatoriske tilslættes og underden pæssettes igen.

3. Testbeholderen drenes rundt og sættes med sugekoppen lodret i akvariet (se fig. 3). Gør det venligst i denne rækkefølge, ikke omvendt. Dette kan føre til fejlmalinger og beskadigelser!

Vigtigt: Vigtigt for at få det nederste hulrum, kun er fyldt delvist med vand.

4. Farekartet sættes yderst på akvarieunderen i nærheden af testbeholderen, så man kan fyde beholderen med akvarievand og indikatorveske igen under punkt 1 - 3 beskrevet. Beholderen renses først.

5. Etter et stykke tid blegner farven i testbeholderen. Så må man fyde beholderen med akvarievand og indikatorveske igen under punkt 1 - 3 beskrevet. Beholderen renses først.

6. Το υδρόβιο από τα είναι γνωστά σφραγίδων που χρειάζονται ασθενή φωτισμό, άλλα ποιητικά, ουργή λίπωση με όλα τα θρεπτικά αυτομάτικα για την υγεία τους ανάπτυξη. Συνδυασμός του υποστρωμάτος sera floredopet, sera florena (υγρό λίπασμα μετάλλων και ασβότη), sera floro drydrops (ημέρια λίπωση), sera floronettede (τραγανές λίπωση), και το σύστημα λίπωσης διαδέσμων sera CO₂-fertilization system εφαρμόζεται έντονα ανάπτυξη φυτών και διατηρεί απόρρετη περιόδου χρήσης.

Οργάνωση: Ανακτήστε κάτια σε φιάλη με πολύτιμα ουσία και γεμίστε την με νερό σε πλήρη στάδιο.

1. Απορρίψτε το πυρηνούσιος κόπων και γεμίστε το με νερό στην επιφάνεια της φιάλης 1,5ml.

2. Προσθέτε 3 - 4 φαρμάκια της CO₂-indikatoriske tilslættes og underden pæssettes igen.

3. Testbeholderen drenes rundt og sættes med sugekoppen lodret i akvariet (se fig. 3). Gør det venligst i denne rækkefølge, ikke omvendt. Dette kan føre til fejlmalinger og beskadigelser!

Vigtigt: Vigtigt for at få det nederste hulrum, kun er fyldt delvist med vand.

4. Farekartet sættes yderst på akvarieunderen i nærheden af testbeholderen, så man kan fyde beholderen med akvarievand og indikatorveske igen under punkt 1 - 3 beskrevet. Beholderen renses først.

5. Etter et stykke tid blegner farven i testbeholderen. Så må man fyde beholderen med akvarievand og indikatorveske igen under punkt 1 - 3 beskrevet. Beholderen renses først.

6. Το υδρόβιο από τα είναι γνωστά σφραγίδων που χρειάζονται ασθενή φωτισμό, άλλα ποιητικά, ουργή λίπωση με όλα τα θρεπτικά αυτομάτικα για την υγεία τους ανάπτυξη. Συνδυασμός του υποστρωμάτος sera floredopet, sera florena (υγρό λίπασμα μετάλλων και ασβότη), sera floro drydrops (ημέρια λίπωση), sera floronettede (τραγανές λίπωση), και το σύστημα λίπωσης διαδέσμων sera CO₂-fertilization system εφαρμόζεται έντονα ανάπτυξη φυτών και διατηρεί απόρρετη περιόδου χρήσης.

Οργάνωση: Ανακτήστε κάτια σε φιάλη με πολύτιμα ουσία και γεμίστε την με νερό σε πλήρη στάδιο.

1. Απορρίψτε το πυρηνούσιος κόπων και γεμίστε το με νερό στην επιφάνεια της φιάλης 1,5ml.

2. Προσθέτε 3 - 4 φαρμάκια της CO₂-indikatoriske tilslættes og underden pæssettes igen.

3. Testbeholderen drenes rundt og sættes med sugekoppen lodret i akvariet (se fig. 3). Gør det venligst i denne rækkefølge, ikke omvendt. Dette kan føre til fejlmalinger og beskadigelser!

Vigtigt: Vigtigt for at få det nederste hulrum, kun er fyldt delvist med vand.

4. Farekartet sættes yderst på akvarieunderen i nærheden af testbeholderen, så man kan fyde beholderen med akvarievand og indikatorveske igen under punkt 1 - 3 beskrevet. Beholderen renses først.

5. Etter et stykke tid blegner farven i testbeholderen. Så må man fyde beholderen med akvarievand og indikatorveske igen under punkt 1 - 3 beskrevet. Beholderen renses først.

6. Το υδρόβιο από τα είναι γνωστά σφραγίδων που χρειάζονται ασθενή φωτισμό, άλλα ποιητικά, ουργή λίπωση με όλα τα θρεπτικά αυτομάτικα για την υγεία τους ανάπτυξη. Συνδυασμός του υποστρωμάτος sera floredopet, sera florena (υγρό λίπασμα μετάλλων και ασβότη), sera floro drydrops (ημέρια λίπωση), sera floronettede (τραγανές λίπωση), και το σύστημα λίπωσης διαδέσμων sera CO₂-fertilization system εφαρμόζεται έντονα ανάπτυξη φυτών και διατηρεί απόρρετη περιόδου χρήσης.

Οργάνωση: Ανακτήστε κάτια σε φιάλη με πολύτιμα ουσία και γεμίστε την με νερό σε πλήρη στάδιο.

1. Απορρίψτε το πυρηνούσιος κόπων και γεμίστε το με νερό στην επιφάνεια της φιάλης 1,5ml.

2. Προσθέτε 3 - 4 φαρμάκια της CO₂-indikatoriske tilslættes og underden pæssettes igen.

3. Testbeholderen drenes rundt og sættes med sugekoppen lodret i akvariet (se fig. 3). Gør det venligst i denne rækkefølge, ikke omvendt. Dette kan føre til fejlmalinger og beskadigelser!

Vigtigt: Vigtigt for at få det nederste hulrum, kun er fyldt delvist med vand.

4. Farekartet sættes yderst på akvarieunderen i nærheden af testbeholderen, så man kan fyde beholderen med akvarievand og indikatorveske igen under punkt 1 - 3 beskrevet. Beholderen renses først.

5. Etter et stykke tid blegner farven i testbeholderen. Så må man fyde beholderen med akvarievand og indikatorveske igen under punkt 1 - 3 beskrevet. Beholderen renses først.

6. Το υδρόβιο από τα είναι γνωστά σφραγίδων που χρειάζονται ασθενή φωτισμό, άλλα ποιητικά, ουργή λίπωση με όλα τα θρεπτικά αυτομάτικα για την υγεία τους ανάπτυξη. Συνδυασμός του υποστρωμάτος sera floredopet, sera florena (υγρό λίπασμα μετάλλων και ασβότη), sera floro drydrops (ημέρια λίπωση), sera floronettede (τραγανές λίπωση), και το σύστημα λίπωσης διαδέσμων sera CO₂-fertilization system εφαρμόζεται έντονα ανάπτυξη φυτών και διατηρεί απόρρετη περιόδου χρήσης.

Οργάνωση: Ανακτήστε κάτια σε φιάλη με πολύτιμα ουσία και γεμίστε την με νερό σε πλήρη στάδιο.

1. Απορρίψτε το πυρηνούσιος κόπων και γεμίστε το με νερό στην επιφάνεια της φιάλης 1,5ml.

2. Προσθέτε 3 - 4 φαρμάκια της CO₂-indikatoriske tilslættes og underden pæssettes igen.

3. Testbeholderen drenes rundt og sættes med sugekoppen lodret i akvariet (se fig. 3). Gør det venligst i denne rækkefølge, ikke omvendt. Dette kan føre til fejlmalinger og beskadigelser!

Vigtigt: Vigtigt for at få det nederste hulrum, kun er fyldt delvist med vand.

4. Farekartet sættes yderst på akvarieunderen i nærheden af testbeholderen, så man kan fyde beholderen med akvarievand og indikatorveske igen under punkt 1 - 3 beskrevet. Beholderen renses først.

5. Etter et stykke tid blegner farven i testbeholderen. Så må man fyde beholderen med akvarievand og indikatorveske igen under punkt 1 - 3 beskrevet. Beholderen renses først.

6. Το υδρόβιο από τα είναι γνωστά σφραγίδων που χρειάζονται ασθενή φωτισμό, άλλα ποιητικά, ουργή λίπωση με όλα τα θρεπτικά αυτομάτικα για την υγεία τους ανάπτυξη. Συνδυασμός του υποστρωμάτος sera floredopet, sera florena (υγρό λίπασμα μετάλλων και ασβότη), sera floro drydrops (ημέρια λίπωση), sera floronettede (τραγανές λίπωση), και το σύστημα λίπωσης διαδέσμων sera CO₂-fertilization system εφαρμόζεται έντονα ανάπτυξη φυτών και διατηρεί απόρρετη περιόδου χρήσης.

Οργάνωση: Ανακτήστε κάτια σε φιάλη με πολύτιμα ουσία και γεμίστε την με νερό σε πλήρη στάδιο.

1. Απορρίψτε το πυρηνούσιος κόπων και γεμίστε το με νερό στην επιφάνεια της φιάλης 1,5ml.

2. Προσθέτε 3 - 4 φαρμάκια της CO₂-indikatoriske tilslættes og underden pæssettes igen.

3. Testbeholderen drenes rundt og sættes med sugekoppen lodret i akvariet (se fig. 3). Gør det venligst i denne rækkefølge, ikke omvendt. Dette kan føre til fejlmalinger og beskadigelser!

Vigtigt: Vigtigt for at få det nederste hulrum, kun er fyldt delvist med vand.

4. Farekartet sættes yderst på akvarieunderen i nærheden af testbeholderen, så man kan fyde beholderen med akvarievand og indikatorveske igen under punkt 1 - 3 beskrevet. Beholderen renses først.

5. Etter et stykke tid blegner farven i testbeholderen. Så må man fyde beholderen med akvarievand og indikatorveske igen under punkt 1 - 3 beskrevet. Beholderen renses først.

6. Το υδρόβιο από τα είναι γνωστά σφραγίδων που χρειάζονται ασθενή φωτισμό, άλλα ποιητικά, ουργή λίπωση με όλα τα θρεπτικά αυτομάτικα για την υγεία τους ανάπτυξη. Συνδυασμός του υποστρωμάτος sera floredopet, sera florena (υγρό λίπασμα μετάλλων και ασβότη), sera floro drydrops (ημέρια λίπωση), sera floronettede (τραγανές λίπωση), και το σύστημα λίπωσης διαδέσμων sera CO₂-fertilization system εφαρμόζεται έντονα ανάπτυξη φυτών και διατηρεί απόρρετη περιόδου χρήσης.

Οργάνωση: Ανακτήστε κάτια σε φιάλη με πολύτιμα ουσία και γεμίστε την με νερό σε πλήρη στάδιο.

1. Απορρίψτε το πυρηνούσιος κόπων και γεμίστε το με νερό στην επιφάνεια της φιάλης 1,5ml.

2. Προσθέτε 3 - 4 φαρμάκια της CO₂-indikatoriske tilslættes og underden pæssettes igen.

3. Testbeholderen drenes rundt og sættes med sugekoppen lodret i akvariet (se fig. 3). Gør det venligst i denne rækkefølge, ikke omvendt. Dette kan føre til fejlmalinger og beskadigelser!

Vigtigt: Vigtigt for at få det nederste hulrum, kun er fyldt delvist med vand.

4. Farekartet sættes yderst på akvarieunderen i nærheden af testbeholderen, så man kan fyde beholderen med akvarievand og indikatorveske igen under punkt 1 - 3 beskrevet. Beholderen renses først.

5. Etter et stykke tid blegner farven i testbeholderen. Så må man fyde beholderen med akvarievand og indikatorveske igen under punkt 1 - 3 beskrevet. Beholderen renses først.

6. Το υδρόβιο από τα είναι γνωστά σφραγίδων που χρειάζονται ασθενή φωτισμό, άλλα ποιητικά, ουργή λίπωση με όλα τα θρεπτικά αυτομάτικα για την υγεία τους ανάπτυξη. Συνδυασμός του υποστρωμάτος sera floredopet, sera florena (υγρό λίπασμα μετάλλων και ασβότη), sera floro drydrops (ημέρια λίπωση), sera floronettede (τραγανές λίπωση), και το σύστη